

27.04.2022

Метрология и Лаборатория



Самое важное для метрологов и специалистов лабораторий

Ряду аккредитованных лиц дополнительно продлили сроки прохождения ПК

Для ряда аккредитованных в национальной системе аккредитации лиц постановлением Правительства РФ от 06.04.2022 N 604 «О внесении изменений в приложение N 17 к постановлению Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 г. N 353» дополнительно продлены сроки прохождения процедуры подтверждения компетентности.

Так, сроки, наступающие для аккредитованных в национальной системе аккредитации испытательных лабораторий (центров) и органов инспекции, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, со дня вступления в силу постановления Правительства РФ от 12 марта 2022 г. N 353 до 31 декабря 2022 года, переносятся на 9 месяцев.

Кроме того, документом определены условия, при соблюдении которых указанные аккредитованные лица получают право в 2022 году участвовать без прохождения процедуры расширения области аккредитации в проведении экспертизы и иных исследований в рамках проведения контрольных (надзорных) мероприятий в соответствии с не включенными в область аккредитации документами.

Подробнее ознакомиться с изменениями вы можете, перейдя по ссылке ниже






Изменения, которые вносятся в приложение N 17 к постановлению Правительства РФ от 12 марта 2022 г. N 353

Наилучшим образом разобраться в нововведениях помогут тематические справочники в системах «Техэксперт»:

- Справочник по метрологии — «Помощник метролога»;
- Справочник по аккредитации — «БНД. Лаборатория».

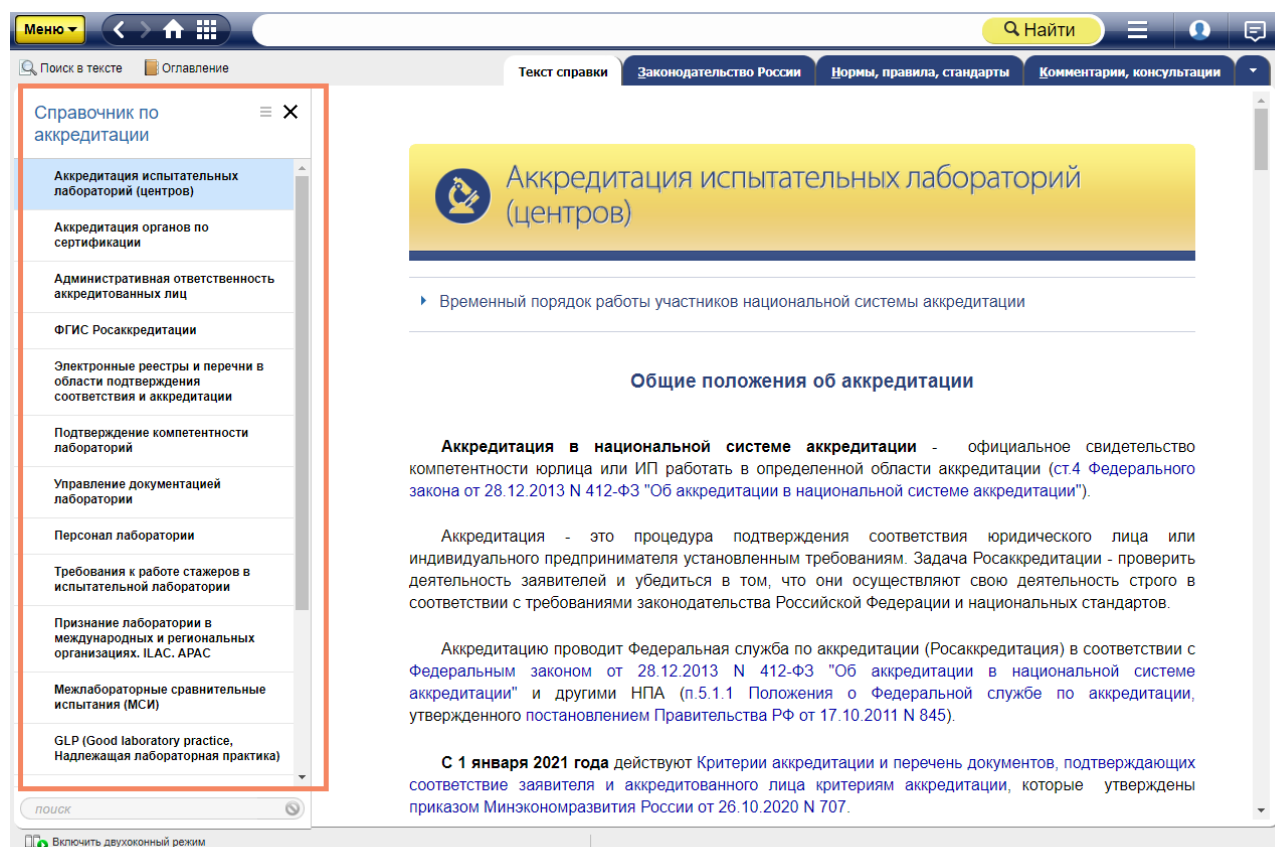

Справочники — это комплексное обеспечение справочной информацией для более эффективной и надежной работы специалистов. Справочная информация подготовлена на основе действующих нормативных правовых и технических документов, регламентирующих деятельность специалистов. Все справочные материалы содержат ссылки на актуальные нормативные документы, образцы и формы, комментарии и консультации.

**Оставайтесь в курсе самых важных новостей в сфере метрологии и лабораторий
с помощью систем «Техэксперт»!**



ПОПРОБОВАТЬ БЕСПЛАТНО

А знаете ли вы?


В Техэксперт добавлены Рекомендации по заполнению анкеты самообследования ИЛ

В систему Техэксперт добавлен новый авторский материал — Рекомендации по заполнению Анкеты (чек-листа) самообследования испытательной лаборатории (центра) на соответствие требованиям Критериев аккредитации, а также ГОСТ ISO/IEC 17025-2019.

Рекомендации подготовил Крикун Василий Михайлович, Советник Генерального директора Ассоциации по сертификации «Русский Регистр», кандидат технических наук, старший научный сотрудник, аудитор в СДС Русский Регистр (МС ИСО 9001, 13485), ГОСТ Р (ISO 9001), СДС Оборонсертифика и СДС Военный Регистр (ГОСТ РВ 0015-002).

Обязательное предоставление анкеты самообследования при подаче заявления об аккредитации с 1 сентября 2022 г. предусмотрено постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2021 г. N 2050 «О порядке осуществления аккредитации в национальной системе аккредитации, расширения области аккредитации, порядке внесения изменений в сведения об аккредитованном лице, содержащиеся в реестре аккредитованных лиц, порядке рассмотрения заявления аккредитованного лица о прекращении деятельности в области аккредитации и принятия национальным органом по аккредитации решения о прекращении действия аккредитации, порядке проведения процедуры подтверждения компетентности аккредитованного лица».

Документ принят в связи с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации».

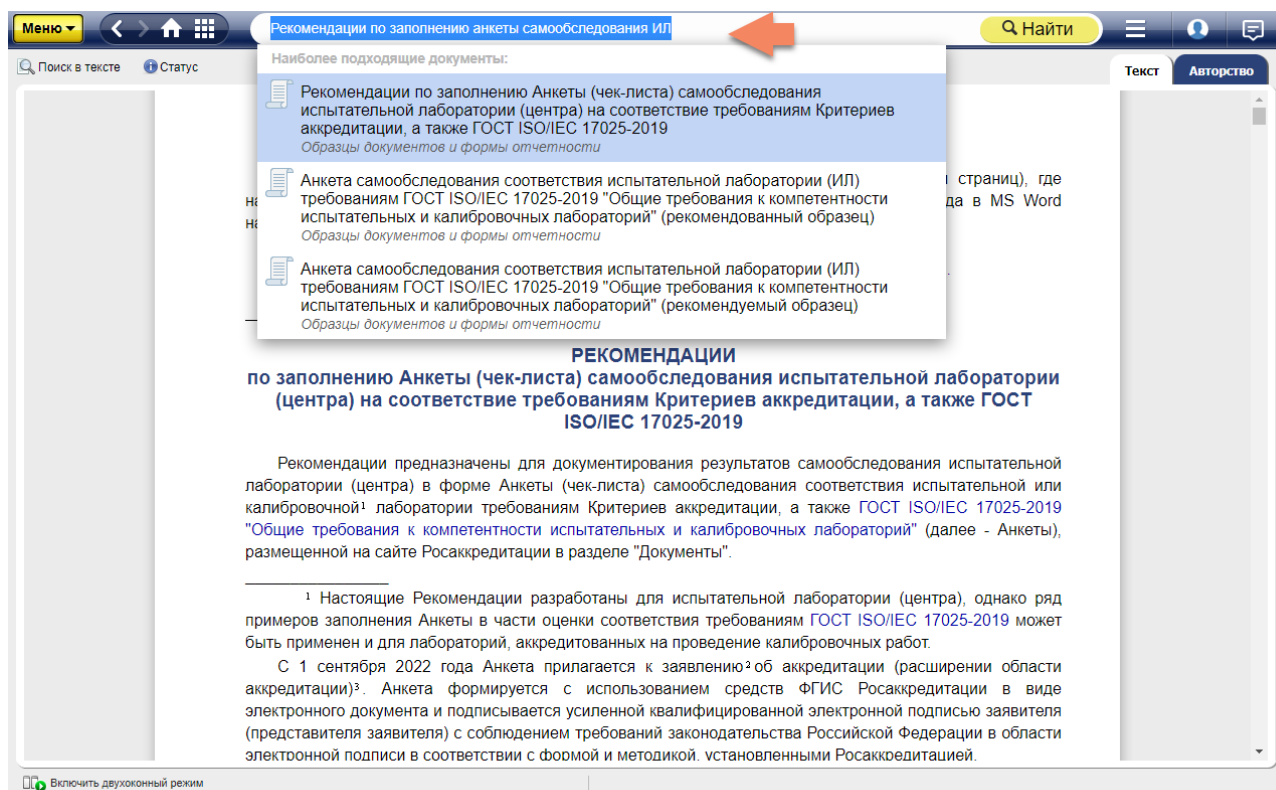

Перейти к рекомендациям вы можете посредством интеллектуального поиска по названию материала.

Еще не работаете с системами «Техэксперт» для метрологов и лабораторий?



ПОПРОБОВАТЬ БЕСПЛАТНО

Вопрос-ответ



Светлов Валерий
Валериевич

Вопрос:

Если диапазон методики измерений находится вне сферы госрегулирования в области обеспечения единства измерений, это означает, что в части данного диапазона испытательная лаборатория (ИЛ) не гарантирует достоверность результата измерений, и данная методика (в части данного диапазона) не может быть включена в область аккредитации ИЛ. Так ли это?

Ответ:

Нет, это не так. Данные методики могут быть включены в область аккредитации.

Обоснование:

Федеральная служба по аккредитации не ограничивает испытательные лаборатории в части методик измерений, диапазоны и погрешности измерений которых выходят за пределы, находящиеся вне сферы госрегулирования. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.11.2020 N 1847 «Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений» (далее — постановление ПП РФ N 1847) приводит обязательные метрологические требованиям к измерениям, выполняемым в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений. Таким образом, при государственном метрологическом контроле будут проверяться только те виды измерений, которые подпадают под государственное регулирование. В этом случае испытательная лаборатория должна обеспечить выполнение измерений в тех диапазонах и с той точной точностью, которые указаны в постановлении ПП РФ N 1847. При этом испытательная лаборатория имеет право работать и в иных диапазонах. Достоверность результата измерений испытательная лаборатория гарантирует проведением внутрिलाбораторного контроля и участием в межлабораторных сличительных испытаниях, что предусмотрено разделом 7.7 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019.

© АО «Кодекс», 2022

Исключительные авторские и смежные права принадлежат АО «Кодекс».

Политика конфиденциальности персональных данных